


Заказ-спецификация для 2 турбинных или для 2 ротационных установок

Наименование организации/ Фирма			Измерит. потока	Линия 1			Линия 2		
			Фирма						
Договор №		Дата	Модель						
Место установки			Диапазон потока	-	м ³ /ч		-	м ³ /ч	
			Коэфф. преобраз.		м ³ /имп			м ³ /имп	
Корректор объема газа		Кол.	Кабель экранир.		м			м	
GVC 2010-10			Датчик давления	Линия 1			Линия 2		
GVC 2010-11			А=абсол. Б=избыт.						
Данные калибровки		P max	Диапазон давлен.	Min	Max		Min	Max	
Макс.давление газа 63 (бара) абс			Укажите (бар)						
Температура газа (C)			Допол. оснащение	Да	Нет		Да	Нет	
CAT 2010-SS содержит		Да Нет	Монтажный блок						
Ист.напряжен 230В AC/24 В DC			Кабель экраниров.		м			м	
Аккумуля. авар. пит. 72 ч			Датчик температуры						
Барьеры Зенера (P,T и Q)			Тип датчика PT 100 DIN IEC 751						
Дополнител. устройства		Да Нет		Линия 1			Линия 2		
Принтер			Един. измер. (мм)	100	160	250	100	160	250
EPSON LX 300+			Длина						
Модем		Да Нет	Дополн. оснащен.	16 бар	60 бар		16 бар	60 бар	
			Защитная гильза						
			Кабель экраниров.		м			м	
Газовый индикатор		Да Нет	Дополнения						
			Укажите размер усл. прохода Ду (мм)						
Кабель экранированный			м						

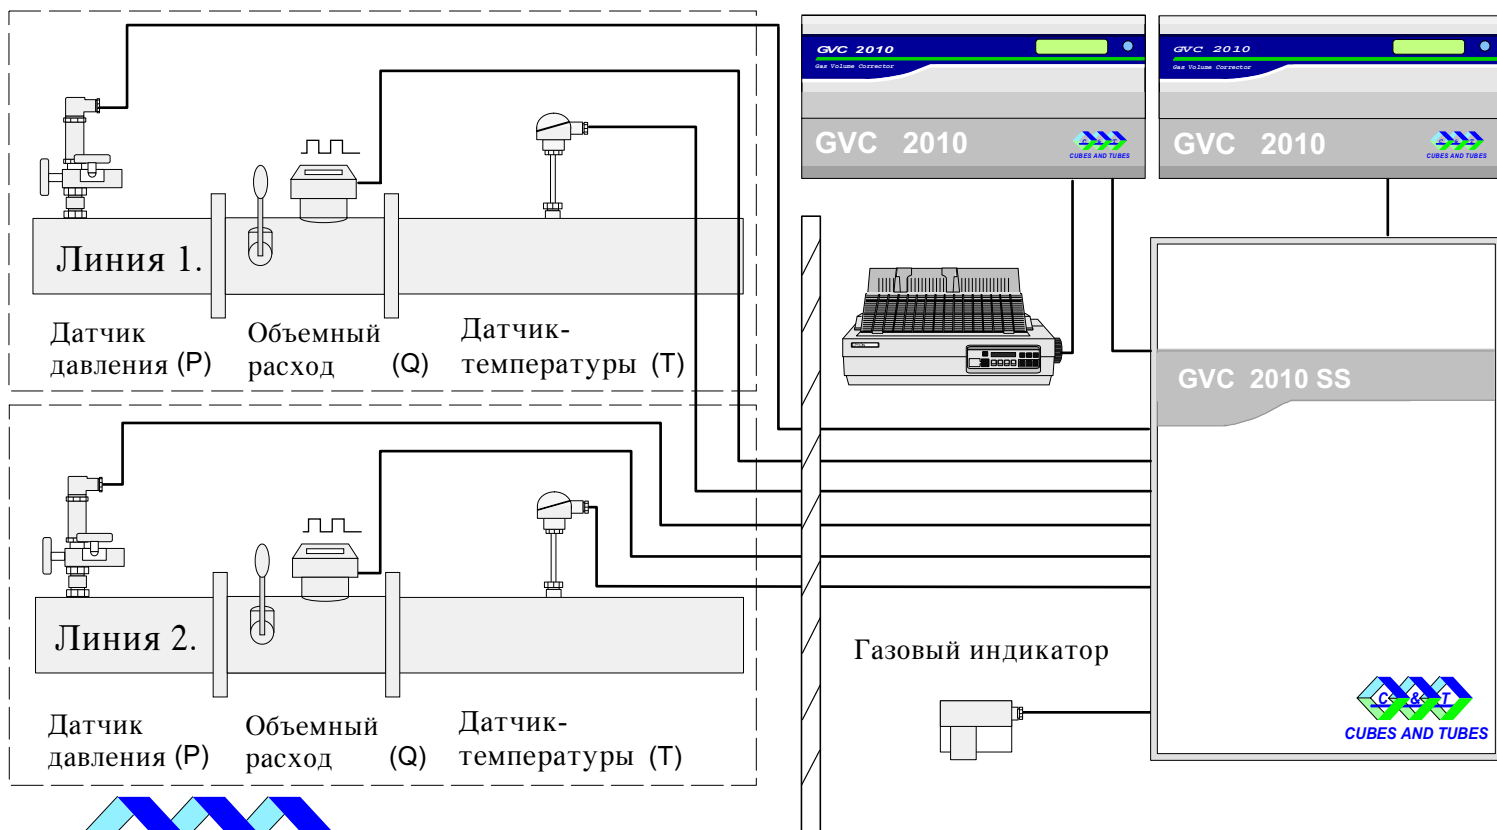

Cubes and Tubes Oy
 P. O. Box 5
 40951 MUURAME, FINLAND
 VERSIO 1.0

Телефон +358 – 14 631 422
 Факс +358 – 14 631 532
 e-mail support@cubestubes.fi 1/1
 CAT2010-4_RU_10.DSF